

No. FZ2002599



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



检测报告

TEST REPORT

委托方	惠州市华迪实业有限公司
生产单位	惠州市华迪实业有限公司
样品名称	折叠口罩
型号规格	KN 95/40 pcs
检测类别	委托检测



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

广东产品质量监督检验研究院
GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

检测报告

TEST REPORT



报告随机号: FTX4287

第 1 页 共 5 页

样品名称	折叠口罩		样品编号	YFZ20/002599
	送样 (√)	抽样 (/)		
商标	PLOW (普滤沃)		型号规格	KN 95/40 pcs
委托方	惠州市华迪实业有限公司		检测类别	委托检测
委托方地址	惠州市惠阳区镇隆镇高田村凤凰岗地段		产品编号/批号	---
生产单位	惠州市华迪实业有限公司		抽样单编号	---
受检单位	---		生产日期	---
抽样单位	---		样品数量	40(个)
抽样地点	---		抽样基数	---
抽样日期	---		检验地点	本部实验室
收样日期	2020 年 03 月 01 日		检验日期	2020 年 03 月 01 日~ 2020 年 03 月 05 日
检测依据	GB 2626-2006 《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》			
判定依据	---			
检测结论	<p>本次委托检测共检 8 项, 所检项目符合标准的要求。</p> <p>(检验检测专用章) 签发日期: 2020 年 03 月 05 日</p>			
备注	报告中的“---”表示此项不适用, 报告中“/”表示此项空白。			

批准:

审核:

主检:

检测 报 告

TEST REPORT

第 2 页 共 5 页

序号	检测项目[单位]	标准条款	标准要求	检测结果		单项结论	备注
1	过滤效率[%]	5.3	KN95 \geq 95.0	未预处理	99.0	合格	/
					98.2		
					97.5		
					98.0		
					98.5		
					98.2		
					97.8		
					97.4		
					99.0		
					98.2		
				预处理	98.2		
					98.5		
					97.3		
			97.1				
氯化钠颗粒物检测	实测温度：(23~25)℃ 实测湿度：(36~37)%		98.4				
	温度：(25±5)℃ 湿度：(30±10)%						
2	吸气阻力[Pa]	5.5	总吸气阻力 \leq 350	未预处理	35.9	合格	/
					37.2		
				预处理	42.5		
					46.1		
3	呼气阻力[Pa]	5.5	总呼气阻力 \leq 250	未预处理	38.0	合格	/
					37.3		
				预处理	45.0		
					40.2		
4	死腔[%]	5.7	以吸入气中二氧化碳体积分数表示时，结果平均值应 \leq 1	平均值：0.9		合格	/

检测报告

TEST REPORT

第 3 页 共 5 页


序号	检测项目 [单位]	标准 条款	标准要求	检测结果		单项 结论	备注
5	头带	5.9	随弃式面罩的每条头带、带扣及其他调节部件在承受 10N, 持续时间 10s 的拉力时, 不应出现滑脱或断裂	未预处理	未出现滑脱、断裂	合格	/
				预处理	未出现滑脱、断裂		
6	连接和连接部件	5.10	可更换式半面罩在规定检测条件下, 可更换式过滤元件与面罩之间的所有连接和连接部件, 在承受 50N, 持续时间 10s 的轴向拉力时, 不应出现滑脱、断裂或变形	未预处理	无此部件, 此项不检	---	/
				预处理			
7	可燃性	5.13	暴露于火焰的各部件在从火焰移开后, 不应燃烧; 如果燃烧, 续燃时间不应超过 5s	未预处理	未出现燃烧现象	合格	/
				预处理	未出现燃烧现象		
8	标识	7	产品上应有以下标识	名称、商标或其他可辨别制造商或供货商的标注	符合	合格	/
				型号和号型 (如果适用)	---		
				执行本标准号和年号, 过滤元件应标注滤料级别, 级别用执行本标准号和过滤元件级别组合方式标注, 如 GB 2626-2006 KN90, 或 GB 2626-2006 KP100	符合		
				名称、商标或其他可辨别制造商或供货商的标注	符合		
			包装: 在最小销售包装上, 应至少以中文用清晰、持久的方式标注, 或透过透明包装可见下述信息	面罩类型、型号和号型 (如果适用)	---		
				执行本标准号和年号, 过滤元件应标注级别, 级别用执行本标准号和过滤元件级别组合方式标注, 如 GB 2626-2006 KN90, 或 GB 2626-2006 KP100	符合		
				产品许可证号	---		
				生产日期 (至少为年月) 或生产批号, 储存寿命 (至少为年)	符合		
“参见制造商提供信息” 字样	符合						
制造商建议的储存条件 (至少包括温度和湿度)	符合						

检 测 报 告

TEST REPORT

第 4 页 共 5 页

照片和说明

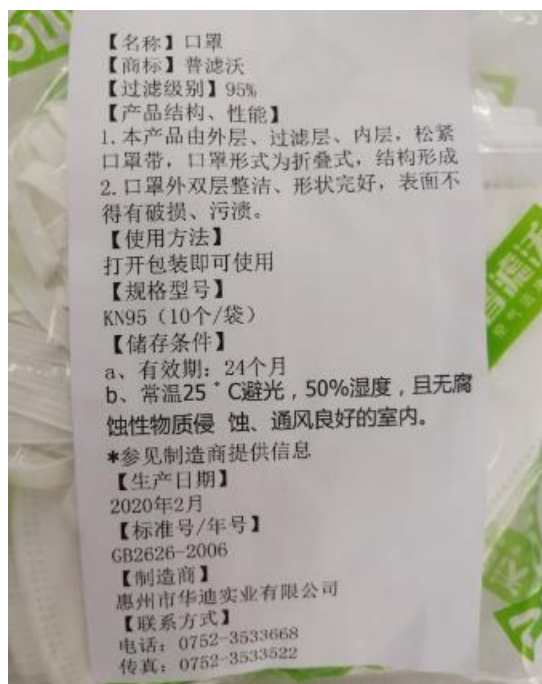

样品描述

/

型号规格或其它说明

KN 95/40 pcs

检测 报告

TEST REPORT

第 5 页 共 5 页

附注:

- 1、试验地点: 广州市黄埔区科学城科学大道 10 号
- 2、委托单位地址及邮编: 惠州市惠阳区镇隆镇高田村凤凰岗地段
- 3、检测环境条件: 检测项目均在相应标准规定的条件下进行 (有注明的除外)
- 4、抽样程序 (如适用): -----
- 5、偏离标准方法的说明 (如适用): -----
- 6、检测结果不确定度说明 (如适用): -----
- 7、分包项目及分包方 (如适用): -----
